


No	サンプル名	回帰式	標準偏差σ	相関係数
○ 1	PVB・A	$Y = 16.830 \cdot X^2 + 0.862 \cdot X + 0.209$	0.03	0.9975
□ 2				
△ 3				
× 4				
◇ 5				
● 6				
▲ 7				
✖ 8				
■ 9				

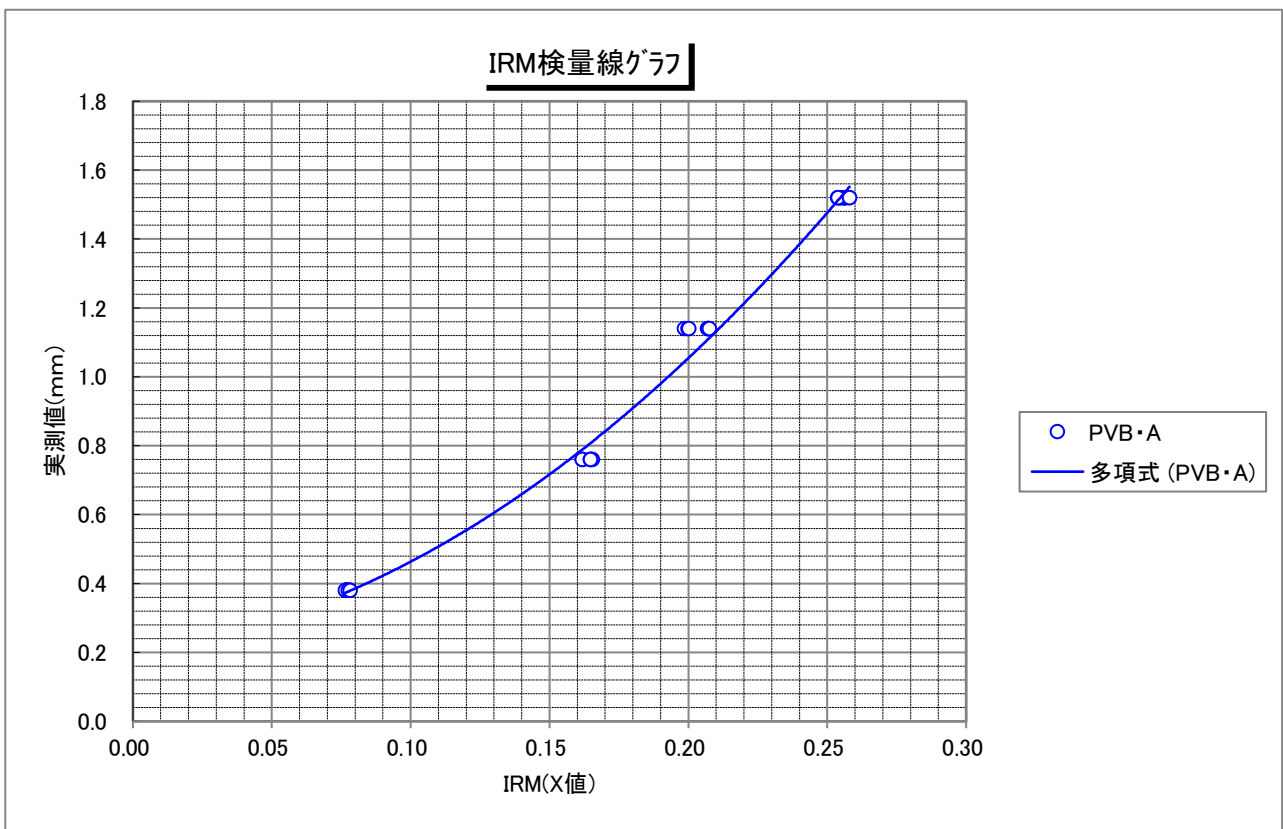

*検量線係数a0～a3は回帰式の0～3次の係数に該当(有効桁数は5桁、それ以下は四捨五入)